





***Lo que necesitas, lo tenemos de entrega inmediata***



***Sin períodos largos de espera.***




9211780762



[ventas@eyassa.com.mx](mailto:ventas@eyassa.com.mx)



[www.eyassa.com.mx](http://www.eyassa.com.mx)

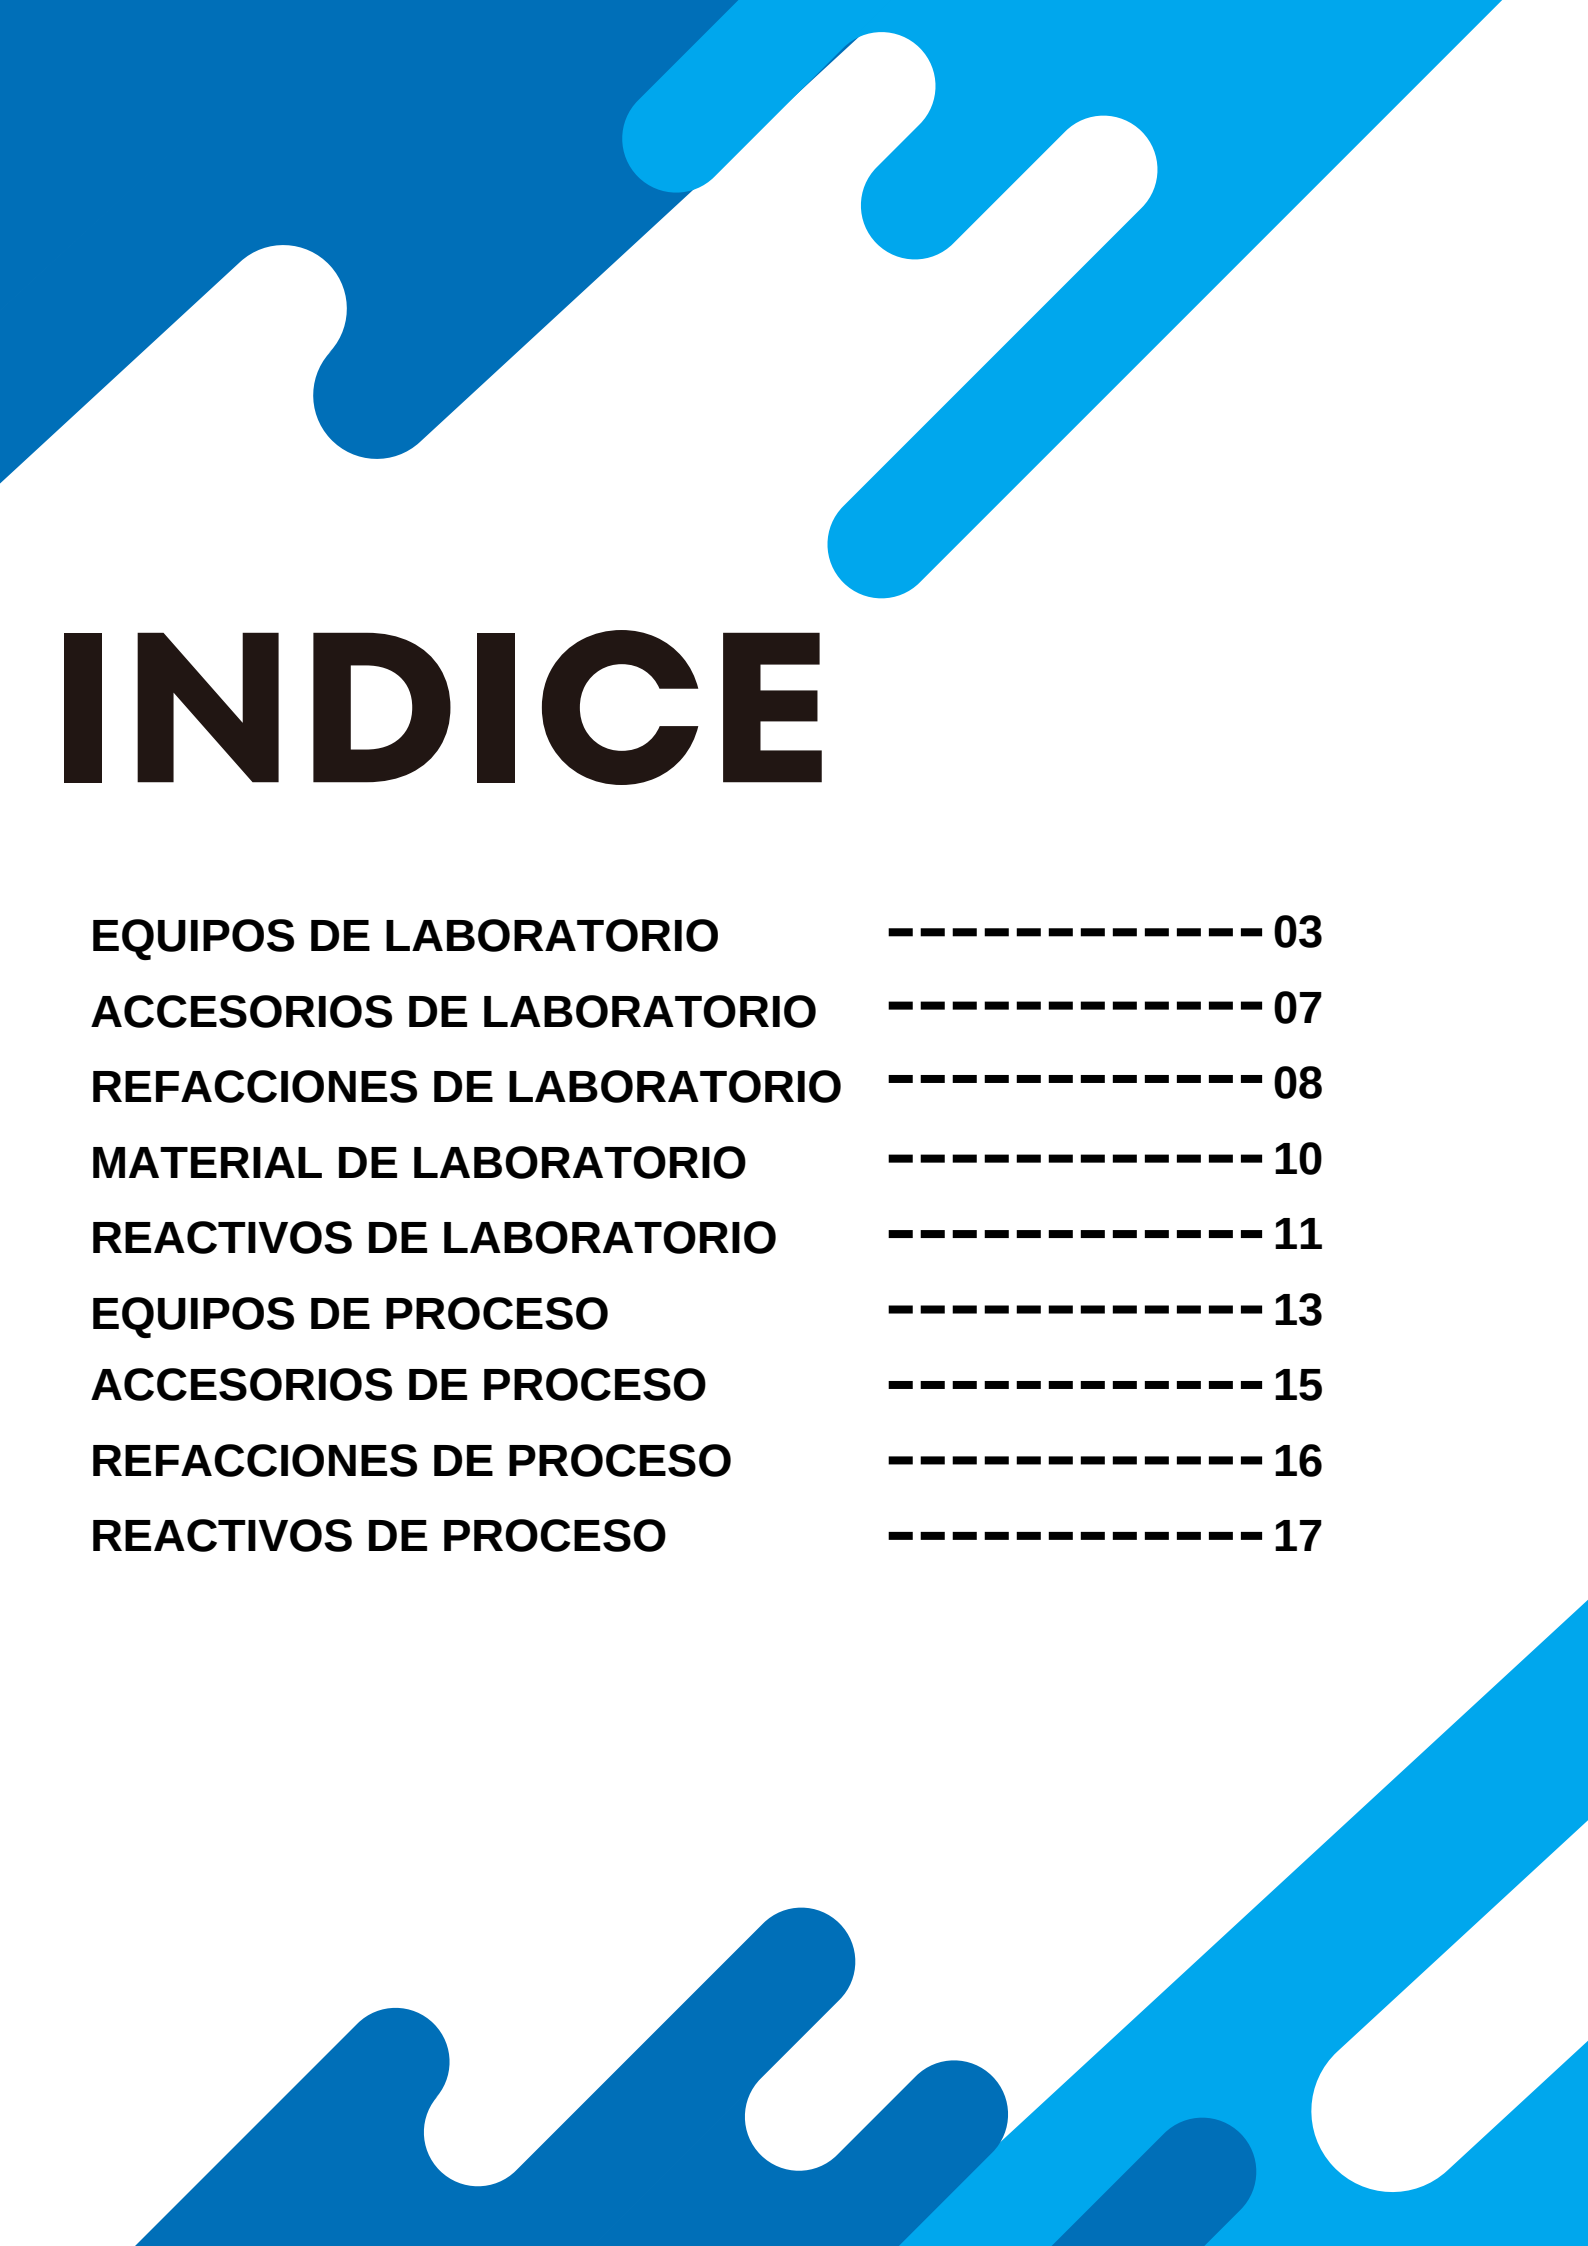

# INDICE

|                            |       |    |
|----------------------------|-------|----|
| EQUIPOS DE LABORATORIO     | ----- | 03 |
| ACCESORIOS DE LABORATORIO  | ----- | 07 |
| REFACCIONES DE LABORATORIO | ----- | 08 |
| MATERIAL DE LABORATORIO    | ----- | 10 |
| REACTIVOS DE LABORATORIO   | ----- | 11 |
| EQUIPOS DE PROCESO         | ----- | 13 |
| ACCESORIOS DE PROCESO      | ----- | 15 |
| REFACCIONES DE PROCESO     | ----- | 16 |
| REACTIVOS DE PROCESO       | ----- | 17 |

# LABORATORIO

## EQUIPOS



### MEDIDOR DE LABORATORIO MULTIPARÁMETRO

Medidor multiparametrico de mesa marca hach modelo hq440d, con entrada para dos sensores, con memoria interna para almacenar lecturas, puerto usb para descarga de datos, interface en 13 idiomas incluidos el ingles y español, reconocimiento automatico



### TURBIDÍMETRO PORTÁTIL

El turbidímetro portátil 2100Q ofrece una gran facilidad de uso y exactitud en la medición de la turbidez. Sólo Hach ofrece esta combinación única de caracterísitcas avanzadas e innovación en la medición, ofreciendo unos resultados exactos en todo momento.



### MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL MP-4

Con recipientes para muestras integrados y sensores internos para mediciones de pH, ORP, conductividad, resistividad y temperatura.



### MEDIDOR TPH1

Portátil, liviano y fácil de operar. Al medir conductividad, TDS, pH y temperatura, los circuitos altamente estables brindan las lecturas precisas necesarias para asegurar la calidad del producto,

# LABORATORIO

## EQUIPOS



### ESPECTROFOTÓMETRO PORTÁTIL DR1900

Este espectrofotómetro portátil y confiable ofrece una precisión de nivel de laboratorio en la que puede confiar dondequiera que lo lleve su trabajo.



### ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS DR6000

Con recipientes para muestras integrados y sensores internos para mediciones de pH, ORP, conductividad, resistividad y temperatura.



### TURBIDÍMETRO TU5200

El turbidímetro de laboratorio TU5200, con la tecnología de detección 360° x 90°, ve más de su muestra, lo que significa que ya no tiene que aplicar aceite de silicona a su vial e índice para garantizar una lectura precisa



### DR3900 ESPECTROFOTÓMETRO DE LABORATORIO

El DR3900 está diseñado para proporcionar resultados precisos rápidamente con los innovadores reactivos TNTplus

# LABORATORIO

## EQUIPOS



### DR900 COLORIMETER

El colorímetro portátil resistente proporciona pruebas de agua rápidas y precisas en el campo y funciona de manera confiable incluso en condiciones difíciles.




### DRB200 BLOQUE DE REACTOR

La solución sencilla para digestiones estándar y especiales.  
15X16M - 15X16M



### DISPENSETTE DOSIFICADOR

Dosificador Dispensette® S Analógico. Volumen fijo de 2mL.  
Sin válvula de purga. Facilita dosificar reactivos agresivos como ácidos concentrados, soluciones alcalinas y solventes orgánicos en general. Fácil de desmontar para su limpieza.



### DISPENSETTE DOSIFICADOR

Dosificador Dispensette® S Analógico. Volumen fijo de 5mL.  
Sin válvula de purga. Facilita dosificar reactivos agresivos como ácidos concentrados, soluciones alcalinas y solventes orgánicos.

# LABORATORIO


## EQUIPOS

| CLAVE           | NOMBRE                              |
|-----------------|-------------------------------------|
| LEV015.53.22006 | KTO:HQ2200/PHC10105/LDO10105        |
| HMP6            | MP-6 PORTABLE METER.                |
| LTV082.53.44001 | DRB200 REACTOR, 110V 30 X 16M       |
| CDC40101        | CONDUCTIVITY PROBE, STD             |
| 1970010         | PIPETA TENSETTE                     |
| 08398=A=2020    | 8398 Inductive Conductivity Sensor, |
| PHC73501        | PHC735 pH PROBE, RED-ROD,           |



# LABORATORIO

## ACCESORIOS




### **PROTECTOR PARA MEDIDOR PORTÁTIL HQD**

Protección adicional contra impactos que requiere el uso en campo. Las correas para la muñeca y el cuello mantienen el medidor seguro.




### **PROTECTOR DE LUZ PARA ESPECTROFOTÓMETROS**

Protector de luz para uso con viales TNT y TNTplus. Protector de luz para DR2700, DR2800 Y DR 3800.



### **ADAPTADOR PARA CUBETA PARA DR6000**

Adaptador para celda de 10 cm de ancho, marca Hach, para espectrofotómetro modelo DR6000.



### **SUMINISTRO DE ENERGÍA**

Suministro de energía de reemplazo para 2100P/2100Q

# LABORATORIO

## REFACCIONES




LAMPARA PARA  
ESPECTROFOTOMETRO  
DR3000

1978600




LAMPARA PARA  
TURBIDIMETRO

4708900



SENSOR PH/ORP PARA  
HMP-6

6PRPR



LENTE DE PLÁSTICO DE  
TURBIDÍMETRO 2100N/2100

4705200



FUENTE DE  
ALIMENTACIÓN DE  
REPUESTO PARA EL DR  
3900

LZV844



SENSOR DE REPUESTO  
PARA EL COMPROBADOR  
DE PH POCKET

9532001



LÁMPARA HALÓGENA DE  
TUNGSTENO, 12 V

A23778



LAMPARA DE REEMPLAZO  
PARA DR2700, DR2800,  
DR3900

LZV565



# LABORATORIO

## REFACCIONES

### CLAVE

### NOMBRE

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 2957200    | CAP FOR BODTRAK 2. HACH                |
| 4418600    | BATTERY, LITHIUM COIN TYPE. HACH       |
| 4700400    | CKT BD ASSY, PREAMP 2100N. HACH        |
| 4705400    | PANEL, PRINTER ACCESS 2100AN. HACH     |
| 5188400    | vv CONTACT, BATTERY, DUAL. HACH        |
| 103769-LM  | FERROUS IRON RGT PP 25ML               |
| A23784     | INTERFACE BOARD. HACH                  |
| A23785     | REFERENCE ELEMENT BOARD DR5000. HACH   |
| 1206499-LM | BARIVER 4 POWDER PILLOWS               |
| HRPHC6     | PH CAP W/FOAM MP-6/MP-6p. HACH         |
| LZT130     | HEATER PLATE DRB200. HACH              |
| LZV587     | SET OF LENSES DR/2800. HACH            |
| LZV609     | DISPLAY FRAME, DR2800. HACH            |
| LZV747     | line filter DRB200. HACH               |
| LZV786     | FILTER KG2. HACH                       |
| LZV885     | DISPLAY AND TOUCHSCREEN DR6000. HACH   |
| LZV921     | SET DE LOGO HACH                       |
| LZV934     | CABLE SETt DR 6000 CAT.                |
| YAB119     | MAIN BOARD WITH PROCESSOR DR3900. HACH |
| YAB124     | MAINBOARD - SPARE DR6000. HACH         |
| 9013000    | SENSOR MODULE,                         |
| 9247100    | DISPLAY WINDOW, pH/Mv, HQ411           |
| 1238       | CAPACITOR, 1000 uF, 35V .300           |
| YAB125     | HALL SENSOR                            |
| 5188800    | vv. CONTACT, BATTERY, DUA              |
| 9601000    | FLASH BOARD ASSY                       |
| 9245700    | DISPLAY-LCD 240X60 TOTS                |
| 9612000    | Optical Bench DR1900                   |
| 4708900    | LAMP REPLACEMENT ASSY, LAB             |
| LZV874     | Protective film for the DR3900/ DR60   |
| LZV831     | ENCLOSURE TOP ASSY, 2100Q,             |
| 102588     | Cable, 1 Pair, Shielded, 22 AWG        |



# LABORATORIO

## MATERIAL

CLAVE

NOMBRE

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 1102        | TERMOMETRO DE MERCURIO. KESSLER                     |
| 137035K106  | PIPETA GRADUADA DE 10 EN 1/10. KIMAX                |
| 1451537     | PIPET, VOLUMETRIC CLASS A. HACH                     |
| 175600      | DISCO DE COLOR P/FIERRO. HACH                       |
| 1864100     | RACK, COD TEST TUBE COOLING. HACH                   |
| 20024-50    | PROBETA DE VIDRIO DE 50 ML. KIMAX                   |
| 2097000     | TOALLITAS DESECHABLES 11X22CM. HACH                 |
| 2185696     | PIPET TIP, FOR 19700-01 PK/50. HACH                 |
| 2416-0060   | FRASCO GOTERO LDPE 60ML. NALGENE                    |
| 253000      | FILTER, GLASS FBR 47MM PK/100                       |
| 45066-20150 | TUBO PARA CULTIVO 20 X 150 M                        |
| 2551910     | DISH, ALUMINUM 90MM PK/50. HACH                     |
| 2558996     | PIPET TIP, STERILE 1-10ML PK/50. HACH               |
| 2929401     | SAMPLER, EXTRA CUP, 500ML. HACH                     |
| 2936100     | FILTER, MEMBRANE GRID 47MM. HACH                    |
| 2965700     | DISPENSING CAP KIT. HACH                            |
| 37022-2101  | PIPETA SEROLOGICA DE VIDRIO. KIMAX                  |
| 4565500     | THERMOMETER, 0 TO 200. HACH                         |
| 45901       | CAP, DISPENSER FOR 253335. HACH                     |
| LAUKA22X22  | CUBREOBJETOS 22 X 22 MM 0.16. LAUKA                 |
| LC211       | CARTUCHO DE PRETRATAMIENTO MARCA: ELGA              |
| LZY421      | 10-CM CELL ADAPTER, DR 5000. HACH                   |
| Z284025     | BARRA MAGNETICA 1/2" X 5/16"                        |
| 10370119    | PAPEL DE FILTRO DE F. VIDRIO DE GRADO GF 8. WHATMAN |
| 15070L-99   | POTECTOR DE TAPÓN, P/BOTELLA . KIMAX                |
| AP10045S100 | COJINETES CON 100 PZ                                |
| 3119-0030   | TUBO PARA CENTRIFUGA DE PPC                         |
| CH20301     | TUBO DETECTOR DE DIOXIDO                            |
| 45241-100   | TUBOS DE CENTRIFUGA DE 100                          |
| 2198720     | FILTER, GLASS FBR 20MM 1.5UM                        |
| 2434706     | SAMPLE CELL, 2100P/Q TURB PK/                       |
| 253000      | FILTER, GLASS FBR 47MM PK/100                       |
| 2401906     | SAMPLE CELL, 25X95MM 10-20-25                       |
| 2410222     | CELDA CUADRADA DE PLASTICO                          |

\*Equipos en existencia salvo venta previa



# LABORATORIO

## REACTIVO

### CLAVE

### NOMBRE

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 0025-1000  | ACETONA GRADO ACS 99.5%,       |
| 2815945-LM | MR TOC RGT SET                 |
| 1406499-LM | DPD TOT CHLORINE PP 25ML       |
| 1407028-LM | DPD FREE CHLORINE 25ML         |
| 143601-LM  | TEST KIT, CA-23 CARBON         |
| 1439301-LM | rr MERCURIC NITRATE 0.2256N,   |
| TNT865-LM  | SULFATE TNT+ HR, 150-900 MG/L  |
| 1454999-LM | CITRIC ACID PP 5ML PK/100      |
| 1517-1000  | KEROSENO DEODORIZADO           |
| 20553      | EDTA STD SOLN, 0.0200N 1000ML  |
| 2314426-LM | POTASSIUM HYDROXIDE STD, 1.0N  |
| 2105769-LM | FERROVER, IRON REAGENT         |
| 2606945-LM | RGT SET, TNT AMVER HR 50 TES   |
| 2105528-LM | DPD FREE CHLORINE RGT, PK/10   |
| 2106469    | AMMONIA 1 RGT PP 10ML PK/100   |
| 2105669-LM | DPD TOTAL CHLORINE RGT PP      |
| 223102-LM  | TEST KIT, CN-66F FREE          |
| 225100-LM  | TEST KIT, SF-1 SULFATE         |
| 2107469-LM | ACID RGT, SILICA HIGH RNG      |
| 2283449    | BUFFER SOLN, RED PH4.01        |
| 2429600-LM | REAGENT SET, SILICA HIGH RAN   |
| 2125915-LM | COD DIGESTION VIAL, HR HW      |
| 2125815-LM | COD DIGESTION VIAL, LR HW PK/  |
| 2283649    | BUFFER SOLN, BLUE PH10.01 500  |
| 2125915-LM | COD DIGESTION VIAL, HR HW PK   |
| 2767245-LM | TNT KIT TOTAL PHOSPHATE HR     |
| 2415915-LM | COD DIGESTION VIAL, HR+ PK/15  |
| 2501025-LM | DISSOLVED OXY LR ACCUVAC       |
| 220399-LM  | SULFITE 1 RGT PWD PLWS         |
| 2105869-LM | CUVER 1, COPPER REAGENT PK/100 |
| 2742645-LM | TNT, TOTAL PHOSPHORUS          |
| 2283649    | BUFFER SOLN, BLUE PH10.01 500  |
| 2283549    | BUFFER SOLN, YELLOW PH7        |
| 2318153    | SODIUM STD SOLN, 100MG/L       |



\*Equipos en existencia salvo venta previa

# LABORATORIO

## REACTIVO


| CLAVE         | NOMBRE                                 |
|---------------|----------------------------------------|
| 230424-LM     | FERROZINE POWDER 25 G                  |
| 2254069-LM    | AMINO ACID F, PP FOR 10ML              |
| 2376626       | MINERAL STABILIZER 50ML                |
| 2507025-LM    | FERROVER IRON ACCUVAC,                 |
| 2544800-LM    | REAGENT SET, FERROMO                   |
| 2459300-LM    | REAGENT SET, SILICA LR 10ML            |
| 2168049-LM    | DEHA REAGENT 2 SOLN, 500ML             |
| 2714100-LM    | RGT SET, TNT HR TOTAL NITROG           |
| HI701-25      | JUEGO DE REACTIVOS P/CLORO             |
| 2770900-LM    | CL02 DPD PP/GLYCINE METHOD             |
| 28232H-LM     | POTASSIUM HYDROXIDE 8N                 |
| K0157.1000    | ACIDO SULFURICO AL 10%, 1 LITR         |
| 126936-LM     | SILICONE OIL 15ML SCDB                 |
| 2608345-LM    | RGT SET, TNT NITRIVER 3 PK/50          |
| 98299-LM      | DISSOLVED OXYGEN 2 PP                  |
| 2672245-LM    | RGT SET, TNT TOTAL NITROGEN            |
| HB-3200738716 | SOLUCIÓN DECONDUCTIVIDAD               |
| K-7355        | COD VIAL KIT 0-150 PPM                 |
| K-7365        | COD VIAL KIT 0-1500 PPM                |
| 2965050       | ELECTRODE FILLING SOLN, 2.44M          |
| LZW9710.99-LM | SOLUCION ESTANDAR DE CONDU             |
| 2105569-LM    | DPD FREE CHLORINE RGT PP PK            |
| 2107369-LM    | MOLYBDATE RGT, SILICA HR               |
| 83843         | YODURO DE POTASIO ACS                  |
| 2589599-LM    | CHLOROPHOSPHONAZO SOLUTION PLWS PK/100 |
| 1407799-LM    | DPD FREE CHLORINE PP 5ML               |
| 2106269-LM    | CITRIC ACID, FOR SILICA PK/100         |
| 2589723-LM    | CDTA SOLUTION, 30ML SCDB               |
| 2744940       | TEST STRIP, LR CHLORIDE BTL/40         |
| 98799-LM      | DISSOLVED OXYGEN 3 PWD                 |
| TNT826-LM     | NITROGEN (TOTAL) TNTPLUS               |



\*Equipos en existencia salvo venta previa

# PROCESO

## EQUIPOS



### ANALIZADOR DE CLORO COLORIMÉTRICO CL17SC

Medición en línea precisa y confiable de cloro libre o residual total



### ANALIZADOR DE DUREZA SP510

Analizador de dureza (punto de activación de 1 mg/L) método de análisis colorimétrico



### BOMBA ENCORE 700 SIMPLEX

Bomba dosificadora de diafragma de accionamiento mecánico, modelo Encore 700



### CONTROLADOR SC4500

Controlador multiparamétrico SC4500, Prognosys, salida 5x mA, 1 sensor digital, 100-240 V CA, sin cable de alimentación

# PROCESO

## EQUIPOS

### CLAVE

### NOMBRE

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| 16L1A0NN        | 4 Point Level Switch,                |
| 199503-LM       | MOLYBDATE 3 REAGENT, 2.9L            |
| 3422B4C         | ASSY-SNSR,COND,K0.5,3/4"             |
| 3455A7A         | ASSY-SNSR,OVERALL,0.05K,             |
| 5440001-LM      | KTO: CHLORINE ANLZR FREE             |
| 3433E8A         | ASY-SNSR,COND.,K10.0                 |
| 3728E2T         | Electrodeless, Convertible, Teflon   |
| 60A2F1278       | pH/ORP Sensor Protector 1 1/2"       |
| 77064-030       | SENSOR ASSY, AV PROBE W/HUB          |
| 9020000         | LDO MODEL 2, 10M HACH                |
| NEO-7012        | TRANSMISOR DE NIVEL ULTRASÓ          |
| E53A2A1N        | Electrodeless, NEMA 2X               |
| 5500.S0.A2U     | ANALIZADOR DE SILICE HACH 550        |
| LXV525.99P11501 | SC4500 W/O PLUG C1D2                 |
| LZU5364.97.0002 | 5364 pH ELECTRODE, DIFF MEDIA        |
| PRO-C3A1N       | PRO Series Transmitter               |
| DPD1P1          | Digital pH Sensor, PEEK, Convertible |
| LXV400.99.10382 | MODULE, PROBE (6 SNSR)               |
| LXV400.99.10172 | MODULE, PROBE, (4 SNSR) SC100        |
| LXV445.99.21112 | TU5300sc TURB,FLOW,SYSCHK,E          |
| 4H1135          | CONN,MALE,THERMOCOUPLE,3/4           |
| NEO-7006        | TRANSMISOR DE NIVEL ULTRASO          |
| 3422A2A         | ASSY-SNSR,COND,K0.05, 1/2            |
| 6028P050        | SNSR-pH, LCP,5W,50                   |
| LXV404.99.00002 | sc200 CONTROLLER, AC-DC              |
| 3422C3A         | Conductivity Sensor,K1.0             |



# PROCESO

## ACCESORIOS

### CLAVE

### NOMBRE

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 1000F3374-002   | 1' SENSOR GUARD, PEEK         |
| 245000501       | POLE, 8-24FT, Q-STICK         |
| 4000F0038-001   | FAB-WEIGHT,KIT,1x9,316SS      |
| LXY060          | sc100 MOUNTING PANEL, DIGITAL |
| LXZ524.99.00005 | SC4X00 UV PROTECTION          |
| LZX914.99.11300 | CHAIN MOUNT KIT, SS, SONATAX  |
| 8315500         | ASSY, MOUNTING BRACKET,       |
| 9012800         | SENSOR MODULE, 4-20 mA        |
| LXZ525.99.D0004 | SC4500 CONDUCTIVITY MODULE    |
| LZU1005.99      | COAXIAL CABLE, AS9            |
| LZU7801.99      | INSERTION FITTING IN 78, SS,  |
| MH518N9A        | FINISHED MOUNTING HARDWAR     |





# PROCESO

## REFACCIONES

### CLAVE

### NOMBRE

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 09240=A=8000    | 1 YEAR SPARE PART KIT SODIUM     |
| 1857100         | O-RING FLCAR.070WX.926ID         |
| 1895000         | LAMP ASSY, 1720 D/E              |
| 4643600         | KIT, FLOWMETER & 1/4 OD TBG      |
| 4697900         | LAMP ASSY SERIES 5000            |
| 5444301         | KIT, CL17 PRE-ASSY MAINT, POST   |
| 60-9765-000-001 | PKG-LCP SALT BRIDGE,QTY          |
| 8573100         | CL17SC CELL CLEANING KIT         |
| 368429,00000    | ELECTRODE, REFERENCE             |
| 6135200         | SENSOR, DIGITAL D.O.             |
| 6782600         | CABLE ASSY, THERMISTOR,          |
| 6788302         | KIT, MAINTENANCE, 5500sc,        |
| 9181700         | SPLIT RING, AMPEROMETRIC         |
| 9181800         | O-RING, 25MM ID X 2.5MM THK,     |
| 9200800         | KIT, DOOR ASSY, BASIC FRONT,     |
| 9240=A=0510     | TAP FOR DIPA BOTTLE W/QUICK      |
| NEO-PFOB        | USB Programming FOB with P.C. So |
| LQV160.99.00002 | SENSOR DE FLUJO P                |
| 4698100         | KIT, MAINTENANCE SERIES 5000     |
| 9200800         | KIT, DOOR ASSY, BASIC FRONT      |





# PROCESO

## REACTIVO

### CLAVE

### NOMBRE

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| 25M3A2100-150K | SOLUCION ESTANDAR DE CONDU       |
| 25255061       | BIOTECTOR ACID REAGENT 1.8 N     |
| 6783600-LM     | KTO: 5500SC SILICA REAGENT       |
| LZY835-LM      | StablCal Calibration Set w. RFID |
| 2974549        | 442-30 TDS STANDARD SOLN, 500    |
| 6774902        | 5500sc REAGENT 2 SILICA 2-LITER  |
| 6774802-LM     | 5500sc REAGENT 1 SILICA 2-LITER  |
| 6775002-LM     | 5500sc STANDARD 1 SILICA 2-LITER |
| 6775102-LM     | 5500sc REAGENT 3 SILICA          |
| 2100803        | SILICA STD SOLN 0.50MG/L 2.9L    |
| 2347003-LM     | CITRIC ACID-SURFACTANT, 2.9L     |
| 2353103-LM     | AMINO ACID F RGT PKG 2.7 L       |
| 4562700-LM     | TO: SILICA REAGENT SET, S5000    |

